




Pacjent _____ ☐ Zamówienie ☐ Wycena (KV) Płeć: ☐ kobieta ☐ mężczyzna ☐ inna Firma Centrum Flebologii Poland customer 100244

Data zamówienia/ pomiaru _____ ☐ Zamówienie wg wyceny (KV) nr _____

Osoba do kontaktu/ zwrótny nr telefonu _____ ☐ Produkt o nr LOT _____ Nr klienta _____

JOBST		Elvarex			Elvarex Plus [▲]		Elvarex Soft Seamless	
	Klasa ucisku (CCL)	1	2	3	1	2	1	2
1	lewa stopa							
	prawa stopa							
2	4 palce	☐	☐	☐	☐	☐	☒	standard
	5 palców	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	skos otworu małego palca	☐ 0,5 cm	☐ 0,5 cm	☐	☐ 0,5 cm	☐	☐	
		☐ 1,0 cm	☐ 1,0 cm	☐	☐ 1,0 cm	☐	☐	
		☐ 1,5 cm	☐ 1,5 cm	☐	☐ 1,5 cm	☐	☒	1,5 cm standard
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	JOBST Elvarex	☐ beż (beige)	☐ karmel (caramel)					
		☐ czarny (black)	☐ opalony (bronze)					
		☐ kakao (cocoa)	☐ szary (grey)					
		☐ żurawina (cranberry)	☐ granat (navy)					
		JOBST Elvarex Plus						
		☐ beż (beige)	☐ karmel (caramel)					
		☐ czarny (black)	☐ opalony (bronze)					
		☐ kakao (cocoa)	☐ szary (grey)					
		☐ żurawina (cranberry)	☐ granat (navy)					
		☐ czerwony (red)						
		JOBST Elvarex Soft Seamless *						
		☐ beż (beige)	☐ szary (grey)					
☐ czarny (black)	☐ kakao (cocoa)							
☐ granat (navy)	☐ żurawina (cranberry)							
☐ wiśnia (cherry)	☐ zielony (pine green)							
☐ złoty (sunflower yellow)								

▲ JOBST Elvarex Plus wymagane jest podanie obwodów wszystkich 5 palców

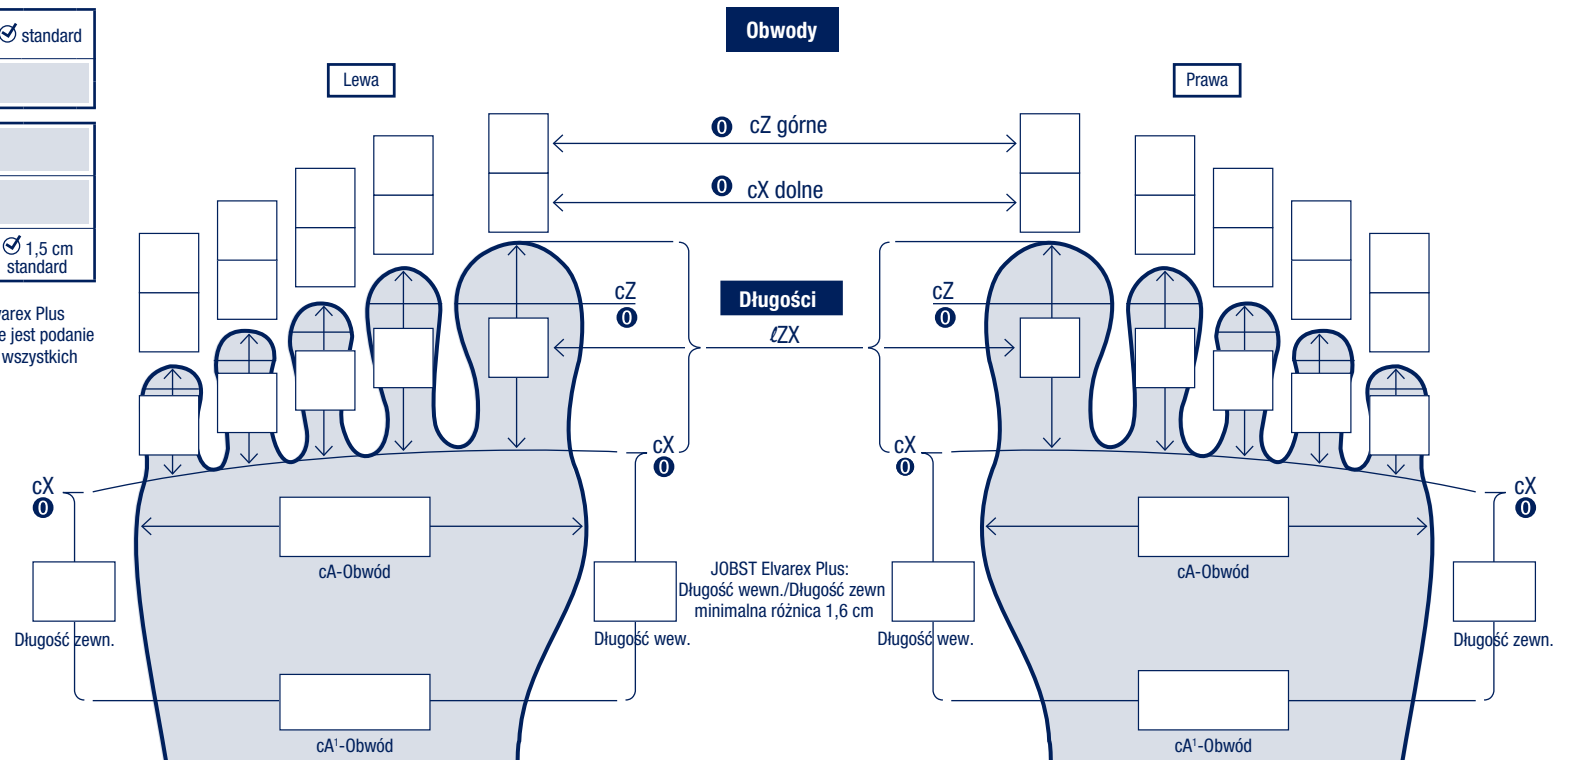

Stosuj różne napięcia miarki: dla zaprojektowania odzieży płaskodzianej z optymalnym efektem terapeutycznym pomiarów obwodów należy dokonywać z różnym napięciem miarki.

① pomiar bez zaciskania miarki

W przypadku stóp, wszystkie pomiary obwodów proszę dokonywać bez zaciskania miarki.

Wyjaśnienia:

_____ / _____